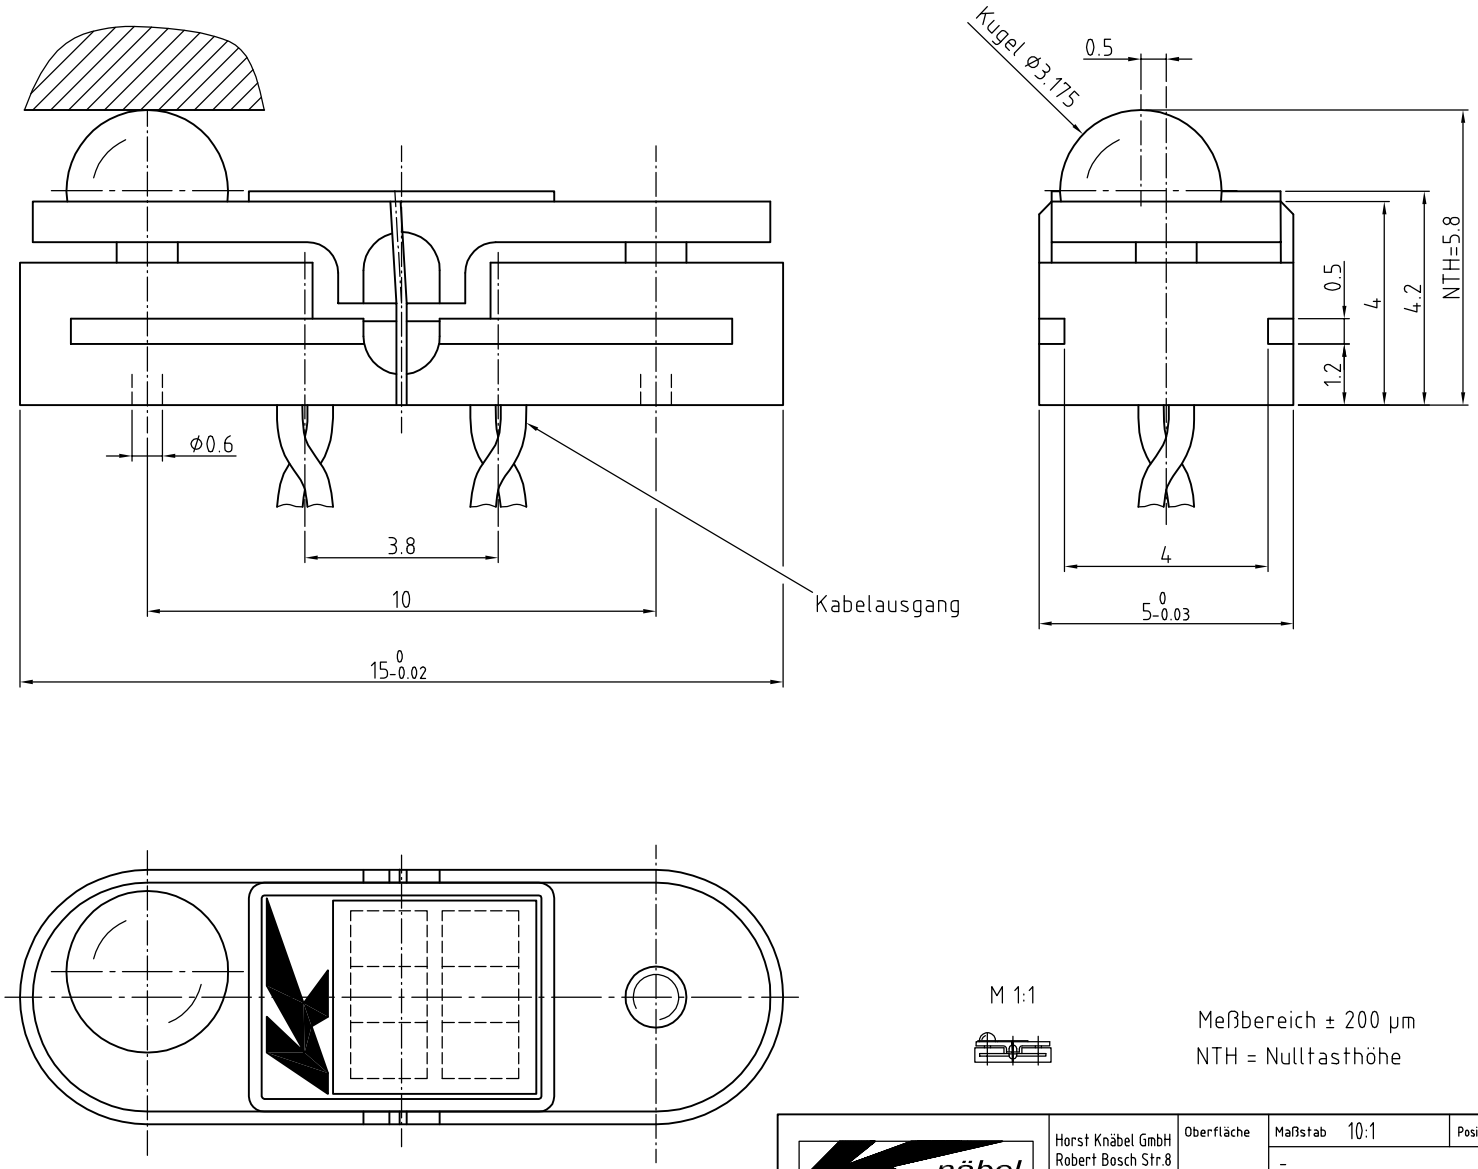

Meßbereich ± 200 µm
NTH = Nulltasthöhe

Knäbel	Horst Knäbel GmbH Robert Bosch Str.8 40668 Meerbusch	Oberfläche	Maßstab 10:1	Position –	Menge –		
			–		–		
			–		–		
		Datum	Name	Induktiver Einbau-Meßtaster			
	Bearb.	18.06.2002	van Dam				
	Gepr.						
	Norm						
				A -0200- 025-		Blatt –	
Zust.	Änderungen	Datum	Name	Dateiname A-0200-025		Bl	